

Découvrez le système de compression thoracique LUCAS[®] 3



Étui LUCAS

Robuste. Intelligent. Moderne.




Étui de transport rigide

- En polycarbonate
- Facile à nettoyer
- Muni d'autocollants réfléchissants
- Grandes poignées multipoints
- Fermeture éclair avec de grandes languettes
- Bretelles ajustables



Conception moulée

- Compacte, transportable et durable
- Pour un contenu protégé et organisé
- Compartiment de stockage des accessoires intelligent (batteries, sangles, ventouses)
- Compatible avec les appareils LUCAS 2

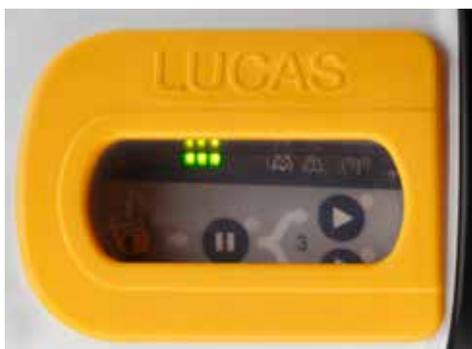

Fenêtre supérieure

- Permet de vérifier rapidement l'état de charge de la batterie (appuyer sur le bouton MUET)



Connexion pour recharger la batterie (à l'arrière de l'étui de transport)

- Permet de recharger le dispositif sans l'enlever de l'étui


Planche dorsale fine LUCAS

Simple. Effilée.



Une seule pièce

- Environ 50 % plus fine
- Facile à nettoyer
- Bords en biais pour faciliter l'ajustement
- Surface de contact plus importante pour plus de stabilité
- Points d'attache supplémentaires pour le transport
- Peut également être utilisée avec les appareils LUCAS 2




Cathétérisme/fluoroscopie

- Permet de réaliser une angiographie/angioplastie d'urgence tout en poursuivant la RCP mécanique sous LUCAS
- Légères ombres visibles en vue oblique (voir l'angiogramme)
- Pour de meilleurs résultats, utiliser la planche dorsale radio transparente (vendue séparément)

Le Système LUCAS

Connecté. Informé.

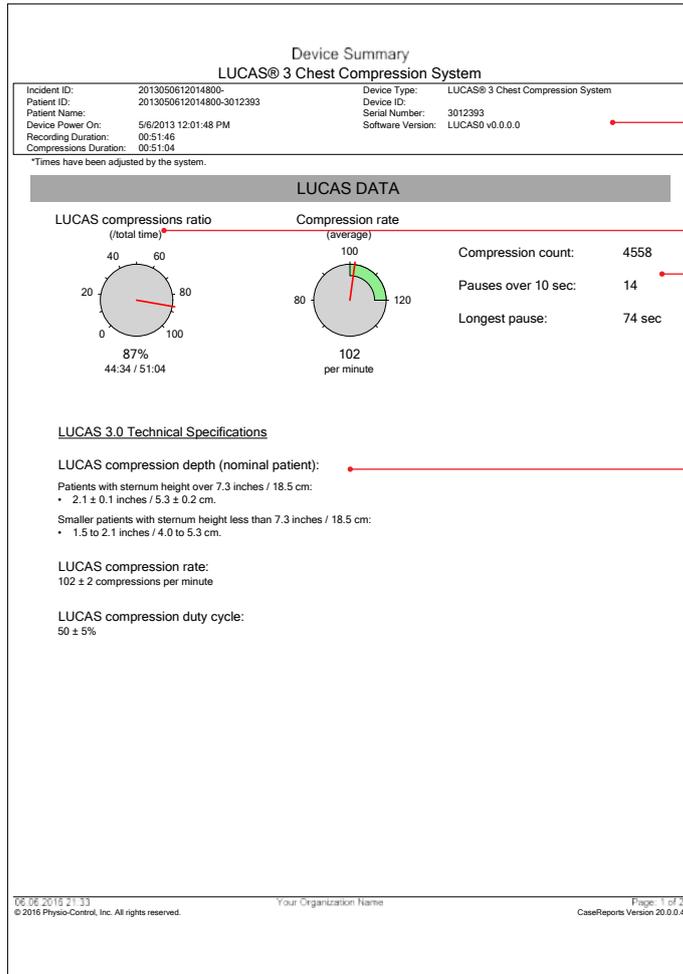

Résumé de l'appareil


Nom du dispositif, date, heure et durée du cas

Compressions LUCAS uniformes, de haute qualité

Affiche le compte des compressions, les pauses >10 secondes et la pause la plus longue

Fraction de compression entre la première et la dernière compression LUCAS

Spécifications techniques du dispositif LUCAS

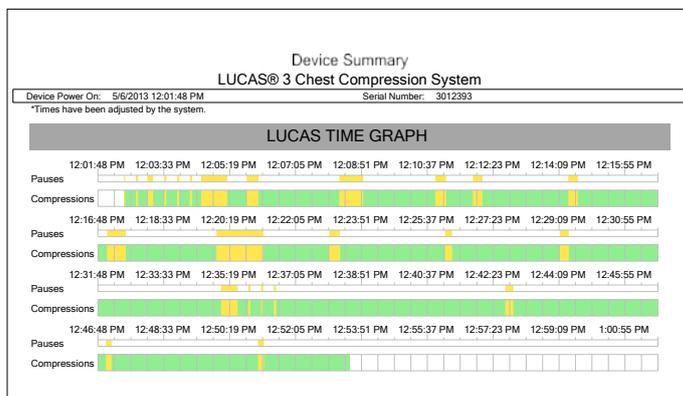

Graphique du temps

- Axe du temps
- Pauses (automatiques du dispositif, ou initiées par l'utilisateur)
- Compressions (du dispositif uniquement)

Spécifications

Compressions

Fréquence de compression : 102 ± 2 compressions par minute

Profondeur des compressions (patient type) :

- 53 mm ± 2 mm pour les patients dont la hauteur du sternum dépasse 185 mm
- 40 mm à 53 mm pour les patients dont la hauteur du sternum est inférieure à 185 mm

Cycle de compressions/décompressions : 50 ± 5 %

Patients éligibles pour le traitement :

- Hauteur du sternum : 17 à 30,3 cm
- Largeur maximale du thorax : 45 cm

L'utilisation du dispositif LUCAS n'est pas conditionnée par le poids du patient.

Spécifications du dispositif

Hauteur x largeur x profondeur (assemblé) :
56 x 52 x 24 cm

Hauteur x largeur x profondeur (rangé dans le sac à dos) : 58 x 33 x 26 cm

Poids du dispositif avec la batterie (sans courroies) :
8,0 kg

Température de stockage du dispositif : -20 °C à +70 °C

Indice de Protection IP du dispositif : IP43

Fonctionnement

Source d'alimentation : Batterie rechargeable Lithium-ion Polymère (LiPo) et alimentation externe ou câble d'alimentation pour véhicule (en option)

Durée de fonctionnement de la batterie (typique) : 45 minutes (typique), temps de fonctionnement plus long avec l'alimentation externe ou le câble d'alimentation pour véhicule (en option)

Alimentation externe : 100-240 VCA, 50/60 Hz, 2,3 A, Classe II, Sortie 24 VCC, 4,2 A

Câble d'alimentation pour véhicule : Tension / Courant 10-28 VCC / 0-10 A

Température de fonctionnement :

- 0 °C à +40 °C

-20 °C pendant 1 heure après stockage à température ambiante

Caractéristiques de la batterie

Temps de charge de la batterie :

Rechargement dans le dispositif LUCAS avec une alimentation externe – moins de deux heures à température ambiante (+22 °C)

Rechargement de la batterie dans le chargeur externe LUCAS – moins de quatre heures à température ambiante (+22 °C)

Poids de la batterie : 0,6 kg

Capacité de la batterie : 3300 mAh (typique), 86 Wh

Tension de la batterie : 25,9 V

Intervalle pour le remplacement de la batterie : il est recommandé de remplacer la batterie tous les 3 à 4 ans ou après 200 utilisations (de plus de 10 minutes)

Température de charge de la batterie : 0 °C à +40 °C (de préférence de +20 °C à +25 °C)

Température de stockage de la batterie : 0 °C à +40 °C et à température de -20 °C à +70 °C pendant moins d'un mois

Indice de Protection IP de la batterie : IP44

Transmission post-interventionnelle des données

Module radio : Bluetooth® v2.1 + EDR de classe 1 – jusqu'à 3 Mbps, Méthode de modulation : 8 DPSK, π/4 DQPSK, GFSKFSK, Canal d'opération : BT 2,4 GHz : can. 0 à 78, Plage de fréquence : 2,4000 à 2,4835 GHz, Fréquence radio : puissance de sortie (Bluetooth) Max + 10 dBm

Toutes les spécifications sont données pour une température de 20 à 25 °C, sauf indication contraire.

Pour de plus amples informations, contactez Physio-Control ou visitez le site web www.physio-control.com



Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
Fax 425 867 4121
www.physio-control.com

**Physio-Control Operations
Netherlands B.V.**
HQ Europe, Middle East & Africa
UP Office Building
Piet Heinkade 55,
1019 GM Amsterdam NL
Tel +31 (0)20 7070560
Fax +31 (0)20 3391194
www.physio-control.com

BENELUX Sales Office
Galjoenweg 68
6222 NV Maastricht NL
Tel +32 (0)70 222 098
Fax +32 (0)70 222 137
www.physio-control.nl

**Physio-Control
France Sales S.A.R.L.**
13 rue Camille Desmoulins
92130 Issy Les Moulineaux
Tél + 33 1 70 36 86 98
Fax + 33 1 58 04 27 29
www.physio-control.fr

**Physio-Control
Canada Sales, Ltd.**
7111 Syntex Drive, 3rd Floor
Mississauga, ON
L5N 8C3, Canada
Toll free 800 895 5896
Fax 866 430 6115